要約取扱説明書

詳細な内容は取扱説明書を参照

メトラー・トレド
XP / XS 分析天びん 並びに 精密上皿天びん

基本機能：

ディスプレイ スイッチ オン / オフ

1.天びんディスプレイのスイッチを入れる：《**On/Off**》キーを短く押します。天びんはシステムテストを行い、使用準備が整います。



2.天びんのスイッチを切る：“Off”が表示されるまで《**On/Off**》キーを押し続けます。天びんはスタンバイモードとなります。



ディスプレイ ゼロ設定

ゼロ設定：«→0←»のキーにより新たにゼロに設定します。

計量作業開始前に、«→0←»のゼロ設定キーを使用します。

ディスプレイ 風袋引き

風袋引き：計量容器を使って作業する場合は、先ず天びん表示をゼロにします。容器を天びんにのせ«→T←»キーを押して、風袋引きを実行します。

その他の機能：

計量アプリケーション

XS 天びん

XP 天びん

アプリケーションの選択：その時点で有効なアプリケーションで作業しない場合は、上の各キーを使用して該当メニューを選択します。

チェック：

水平調整、内蔵分銅による調整（工場設定）

1.本体の水準器表示では非水平状態



2.ディスプレイの水準器では非水平状態*

3.水平調整脚の固定解除*



4.水平調整実行。調整完了後、再度固定します。



5. 内蔵分銅での調整

内蔵分銅での調整を自動的に実行する時点です。手動で調整する場合は、水平状態をチェックして、《Int.チョウセイ》ファンクションキーを押すと、内蔵分銅による調整が開始されます。



計量特性：精密計量 / 計量スピード

計量フィルター：計量モード

1.システム設定の選択

2.計量パラメータの選択

3.計量モードの選択



ヒント：
固体計量 ：《イッパン》

粉末、液体：《ハカリコミ》

計量フィルター：周囲環境

1.システム設定の選択

2.計量パラメータの選択

3.周囲環境条件の選択



ヒント：ヒュームカップボード、不安定な計量台：《ファンテイ》、《タイヘンファンテイ》

安定した計量台、通風無し：《フツウ》、《シズカ》

計量フィルター：計量値のリリース

1.システム設定の選択

2.計量パラメータの選択

3.計量値リリースの判定基準の選択



ヒント：最高精密水準：《タカイシンライセイ》

計量値を素早くリリースする：《タイヘンハヤイ》、高い信頼性の代わりに値が直ぐに出ます。

ユーザープロファイルの選択

“Home”プロファイルの他に 7 種類のユーザープロファイルを利用可能で、その設定内容を必要に応じて適切に変更できます。

例



計量プロファイル：
* XP 型のみ

メトラー・トレド Excellence Plus 並びに Excellence 天びん

XP 分析天びん並びに精密上皿天びんのディスプレイ概要：

XP ディスプレイ ターミナル

1. スマートセンス：
両方の各タッチレスセンサーにキー機能及びメニュー機能を割当可能。

2. Home:
これにより、ユーザープロファイルでの任意のアプリケーションの任意のメニューレベルから“Home”へ復帰可能。

3. ユーザープロファイル・キー：
このキーにより希望のユーザープロファイルを呼び出します。

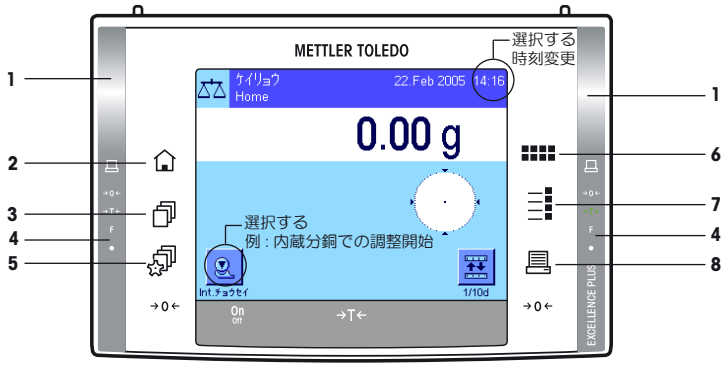

4. ステイタスバー：
左右のスマートセンスにそれぞれあるキー機能が割り当てられていると、該当シンボルが点灯します。

5. システム設定：
基本設定を変更する。

6. 計量アプリケーションの切り換え

7. アプリケーションの設定：
このキーによりその時点で有効なアプリケーション設定を構成するメニューを呼び出します。

8. プリンタ：
このキーを押すと、データがインターフェイスを介して伝送されます。

XS 分析天びん並びに精密上皿天びんのディスプレイ概要：

XS ディスプレイ ターミナル

1. Home:
このキーにより、任意のメニューレベルから直接その時点で有効なアプリケーションへ復帰することができます。

2. 計量アプリケーション：
このキーにより作業に使用するアプリケーションを選択します。

3. アプリケーションの設定：
このキーによりその時点で有効なアプリケーションを構成するメニューを呼び出します。
例、日付の変更

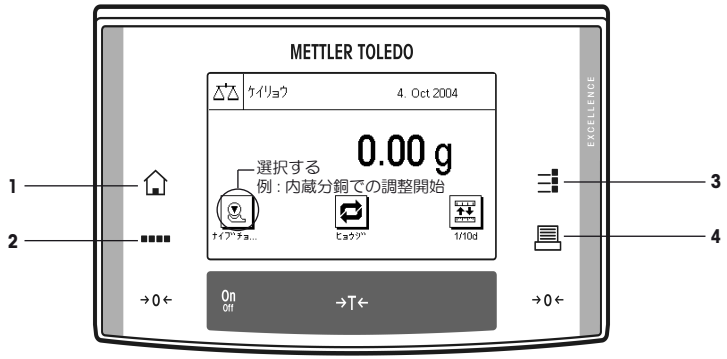

4. プリンタ：
このキーを押すとデータがインターフェイスを介して伝送されます。

© Mettler-Toledo AG 2007
11781031 Printed in Switzerland 0707/7.16

Mettler-Toledo AG, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41-44-944 22 11, Fax +41-44-944 30 60, Internet: http://www.mt.com